Sillón

GINECOLOGICO

Sillón exploración ginecoógica

Sillón de exploración ginecológico de tres cuerpos, equipado con actuador eléctrico para regulación de la altura, diseñado con el fin de garantizar las más rigurosas normas técnicas para ser utilizada en la exploración e intervención dentro del área de ginecología.

Datos Técnicos

Longitud superficie de descanso	180 cm. ± 10 mm.
Ancho superficie de descanso	62 cm. ± 10 mm.
Mínima altura superficie de descanso	53 cm. ±10 mm.
Máxima altura superficie de descanso	85 cm. ±10 mm.
Inclinación máxima del respaldo	85º
Inclinación trendelenburg	10º
Carga máxima de usuario	200 kg.

* Las medidas y la información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones que se pueden elegir

Certificados

La empresa Industrias Pardo s.l. cuenta con los siguientes certificados: UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 13485, UNE-EN ISO 14001.

El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas, producto CE Fabricado en España.

Respaldo Elevable

La elevación y el descenso del respaldo se realiza suavemente a través de un sistema eléctrico de accionamiento mediante mando de control.

El funcionamiento mediante motor eléctrico, le permite rango de inclinación muy variado, con un posicionamiento máximo de inclinación de 85º.

Su total independencia con respecto al resto de la camilla, le permite una mayor comodidad al paciente.

Extremidades reclinable

El reposapiernas ofrece la máxima comodidad tanto a pacientes, colocándose de manera horizontal y permitiendo un apoyo completo del paciente, además de una mayor comodidad al servicio médico a la hora de trabajar, gracias a su posibilidad de colocación de manera vertical.

Accionamiento mediante palanca.

Sistema de Elevación

La elevación y el descenso ser realiza suavemente a través de un sistema eléctrico de accionamiento mediante mando de control. Los niveles de esfuerzo son mínimos para el personal médico.

Alcanza valores mínimos y máximos de elevación de 53 y 85 cm. respectivamente, facilitando las labores de asistencia por parte del personal de hospital y minimizando lesiones músculo esqueléticas.

Trendelenburg compensado

El sillón dispone de un sistema de emergencia eléctrico, en el que se articulad el sillón en posición Trendelenburg, mediante accionamiento con el mando de control.

Favoreciendo al personal médico, en la realización de maniobras de emergencia sin tener que trasladar al paciente a otras estancias.

Estructura

Con una estructura resistente realizada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster que le confiere alta resistencia a los impactos, una gran adherencia y una excelente resistencia a la oxidación.

Perneras Ginecológicas

La camilla dispone de un juego de perneras ginecológicas anatómicas, basculantes de altura regulable y giratorias.

Fabricadas en acero inoxidable y las partes en contacto con el paciente, están fabricadas con las mismas espumas y tapizados que el sillón, ofreciendo un apoyo cómodo.

Colchoneta

Formada por una base de 8 cm de espuma de poliuretano (30 kg/m3).

La espuma, cubre hasta el lateral de la colchoneta, permitiendo las transferencias de los pacientes, sin entrar en contacto con la estructura.

Espuma tapizada con tejido vinílico, antimicrobano, antibacteriano, de alta resistencia a la abrasión, transpirable e impermeable, resistente a la orina, a la sangre y a las manchas e ignífugo.

Bandeja de residuos

Entre la parte central y el reposapiernas, el sillón tiene un hueco diseñado especialmente para el tratamiento ginecológico.

En este hueco se encuentra añadida, una bandeja extraíble de acero inoxidable, para la recogida de residuos.

Cojín Cervical

Almohada cervical ajustable, para aumentar la comodidad del paciente.

Comodidad,
Ergonomía y Calidad

Tapizados

Acabados disponibles

VALENCIA

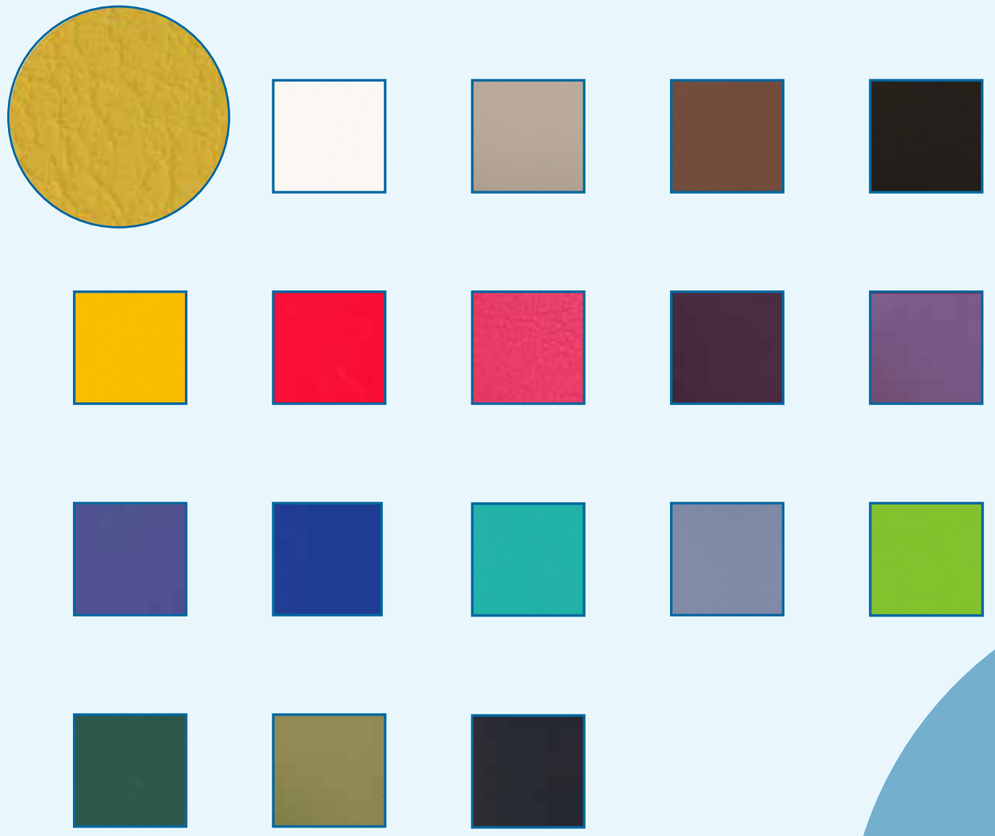

Guía de cuidado y limpieza

Limpieza de los tapizados

Para la limpieza del tapizado utilizar agua y jabón neutro. El tejido tiene una capa protectora con protección antimicrobiana, antimicótica, antibacteriana, con resistencia a la abrasión (>300.000 ciclos Martindale), resistencia a las bajas temperaturas y resistencia a la luz UV, por lo que si se utilizan productos abrasivos, como el alcohol de alta graduación, esta capa protectora quedará inutilizada. Sin esta capa protectora la polipiel con el uso se cuarteará.

- El tejido vinílico se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y mugre.
- Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente.
- Use soluciones jabonosas suaves o productos de limpieza especiales para telas de tejido vinílico, para eliminar las manchas de la superficie del material.
- Limpie solamente con trapos blancos humedecidos.
- Las lacas, los limpiadores fuertes, los detergentes, los líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK causan un daño inmediato y contribuyen al deterioro del material.

El uso de estos limpiadores es bajo su propia responsabilidad.

Mantenimiento

Para un buen funcionamiento y mantenimiento de las camillas, lubricar las articulaciones cada tres meses aproximadamente, o ante cambios bruscos de temperatura.

Como lubricar las articulaciones:

- Afloje las tuercas de las articulaciones.
- Ponga lubricante.
- Suba y baje la camilla varias veces
- Apriete las tuercas de manera que no queden demasiado apretadas. De esta forma evitará ruidos molestos.

Los Ángeles nº 5. Pol. Ind. Centrovía, 50198 La Muela (Zaragoza, España)
www.pardo.es
Tel: 976 300 033 - Fax: 976 320 647